



---

# Instructions D'utilisation Gphantom Vessie

Ce manuel contient des informations et des instructions sur le modèle Gphantom Vessie.



APPRENEZ. PRATIQUEZ. PERFECTIONNEZ.



Merci d'avoir choisi **Gphantom**!

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le développement de solutions pour la formation médicale. Ici, nous vous aiderons à gérer et à optimiser la durabilité de votre produit. Si vous recherchez des modèles spécifiques pour votre formation, n'hésitez pas à nous contacter.

Votre **Gphantom Vessie** est éligible au programme de fidélité Gfantôme.

Voir conditions.

APPRENEZ. PRATIQUEZ. PERFECTIONNEZ.



### Recevoir votre Gphantom

Gphantom Vesical permet une formation au passage du cathéter urinaire guidée par échographie. Développé pour simuler une vessie mesurant environ 200 ml, ce modèle permet aux professionnels et aux étudiants de pratiquer les techniques de sondage appropriées en toute sécurité et efficacement. La vessie simulée est équipée d'un système qui permet la visualisation des liquides, confirmant l'insertion correcte de la sonde guidée par ultrasons.

Idéal pour les établissements d'enseignement et de formation, le Gphantom Vesical peut être rempli d'eau ou de solution saline grâce à une connexion de type \*luer lock\*, étant un modèle de bonne durabilité pour la formation de grandes classes, avec un nettoyage simple offrant un apprentissage réaliste et une assurance pour les professionnels en formation.



### Recevoir votre Gphantom

L'emballage de votre Gphantom Mode B contient:

- Modèle emballé dans du papier bulle;
- Carte code QR pour accéder aux manuels.

### Commencer votre formation


- Retirez le modèle de l'emballage en gardant le produit sur la base d'origine;
- Préparez votre échographe et votre équipement;
- Séparez les aiguilles et autres matériaux nécessaires;
- Accédez à notre ebook ([ebook.gphantom.com.br](http://ebook.gphantom.com.br)) pour tirer le meilleur parti de votre formation.





## Échographie

- Positionnez correctement le modèle pour utiliser les ultrasons.
- Appliquez une petite couche de gel de contact sur le produit ou le transducteur, en quantité suffisante pour faire glisser facilement le transducteur sur le modèle. Ajoutez plus de gel si nécessaire.
- Ajustez le système de contrôle par ultrasons selon votre protocole.
- Positionnez l'image selon vos besoins.
- Les structures sont imagées dans différents plans, en fonction du positionnement et de l'angle du transducteur par rapport au tissu. L'optimisation d'une image en mode B dépend de plusieurs facteurs, tels que les réglages de l'équipement et le positionnement du transducteur. Il est donc important de comprendre la relation entre le plan de l'image échographique et la morphologie du tissu imagé. Pour plus d'informations, revenez à notre ebook en ligne présenté au début de ce manuel.
- Le positionnement correct du transducteur, qui permet d'obtenir des images précises avec une luminosité optimisée, s'effectue avec la sonde dans une position perpendiculaire au tissu. Lorsque le transducteur est incliné, formant un angle inférieur à  $90^\circ$  avec la surface du tissu, la luminosité de l'image diminue et la représentation de la structure est déformée.

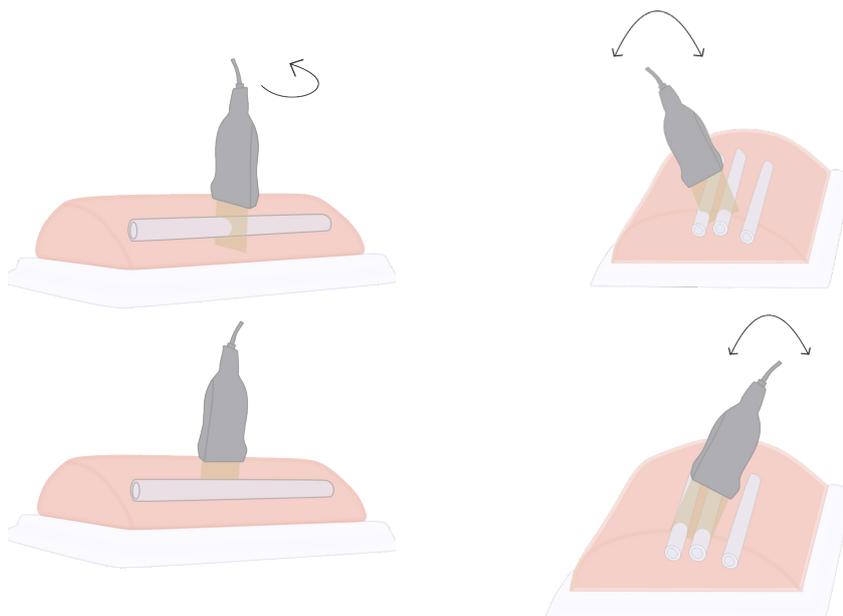



## Aiguillage


- Pour de meilleurs résultats de récupération des marques d'aiguille, nous vous recommandons d'utiliser des aiguilles jusqu'à 23G. Cependant, il est possible d'utiliser Gphantom pour la formation Core-Biopsy, en profitant de la longueur des modèles de blocs de formation. Même si l'utilisation d'aiguilles de plus gros calibre réduit la durée de vie utile des Gphantoms, notre technologie de récupération des marques d'aiguille continue de fonctionner sur les modèles, garantissant une bonne durabilité.

### 1. EN AVION

- Dans l'approche dans le plan, toute la longueur de l'aiguille est visualisée, dans une vue longitudinale. Il est possible d'obtenir une visualisation continue de la trajectoire de l'aiguille et de sa pointe.

### 2. HORS PLAN

- Dans l'approche hors plan, l'aiguille est insérée orthogonalement au plan d'imagerie, obtenant une image transversale de la position de sa pointe, qui est visualisée comme un point brillant.

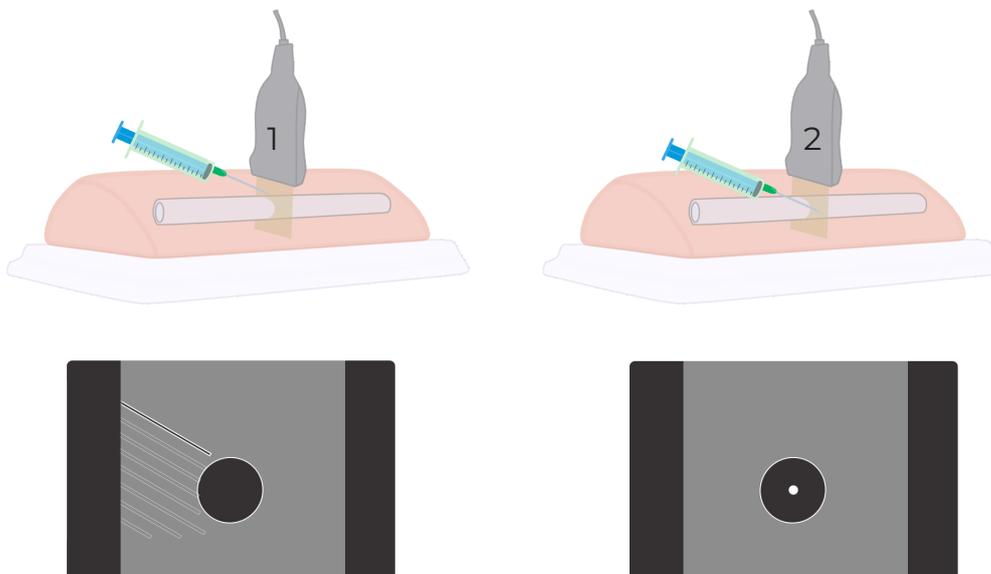

## Remplacement du fluide


- Pour une plus grande durabilité de votre Gphantom, nous vous déconseillons d'injecter ou d'aspirer des liquides contenus dans les matériaux. Toutefois, s'il s'agit d'une alternative à la formation applicative, voici quelques conseils pour optimiser l'utilisation de votre modèle.
- Éliminez tout l'air de l'aiguille avant d'infuser des anesthésiques simulés dans le modèle.

REMARQUE : Si vous injectez accidentellement de l'air dans le modèle pendant l'entraînement, de l'air risque de rester dans le tissu ou le trajet de l'aiguille. Éliminez l'air emprisonné en injectant du fluide au même point d'accès jusqu'à ce que l'air soit expulsé du système.

- Injectez le liquide, utilisez de préférence une solution saline, sinon utilisez de l'eau.

REMARQUE : environ 200 mL.

- Une fois la procédure d'injection terminée, retirez le liquide du modèle en tirant sur le piston de la seringue pour retirer le liquide perfusé.

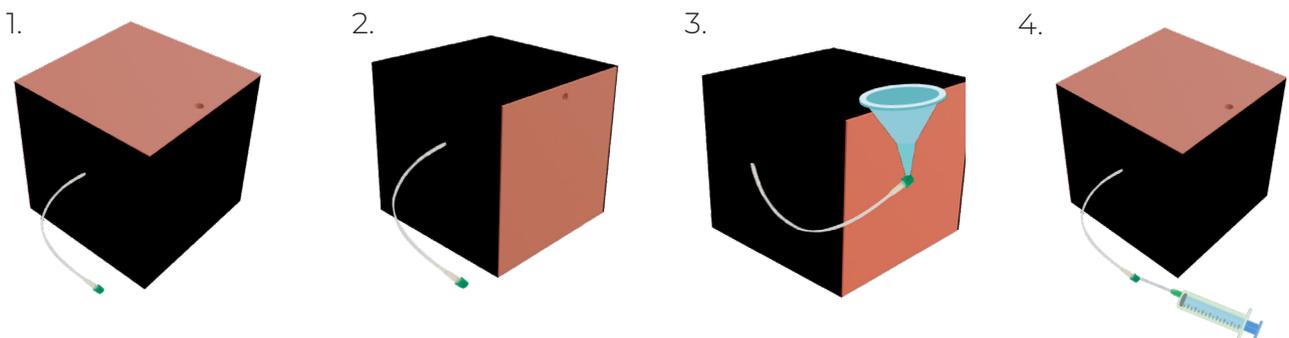

Positionnez correctement le produit, avec le trou sur la surface vers le haut (Figure 2), pour que tout l'air à l'intérieur sorte. Ensuite, à l'aide d'un segringa, ou entonnoir, ajoutez environ 200 ml d'eau ou de solution saline, jusqu'à ce que vous remarquiez que le liquide sort du trou de surface (Figure 3).




Enfin, fermez le piston de la seringue et remettez le produit dans sa position initiale (Figure 4).



## Manipulation et Conservation

- Effectuez uniquement les procédures prises en charge par chaque produit, comme décrit dans ce guide;
- Utilisez uniquement des aiguilles pour accéder aux liquides;
- N'utilisez pas et ne rangez pas d'autres objets pointus, tels que des ciseaux, des scalpels ou des cutters, à côté de votre Gphantom;
- N'insérez aucun objet ou outil dans le modèle, à l'exception des équipements médicaux, des accessoires ou des fournitures destinés à être utilisés avec ce modèle;
- N'utilisez pas de solvants chimiques sur les modèles ;
- Conservez toujours votre produit dans son emballage et dans un endroit frais, à l'abri du soleil;

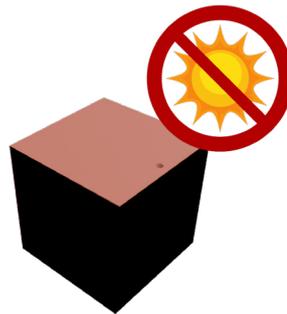

- Exposer votre Gphantom à des températures supérieures à 30°C pendant de longues périodes peut entraîner des modifications des propriétés du produit. Après l'entraînement, nettoyez le produit avec une serviette en papier, en enlevant l'excès de gel à ultrasons, puis lavez-le sous l'eau courante, sans le retirer de la base;
- Ne stockez pas Gphantom avec un excès de gel, car cela pourrait provoquer la prolifération de micro-organismes susceptibles d'endommager le produit;
- N'utilisez pas de détergents ou d'éponges, car cela endommagerait le produit!



## Nettoyage

- Nettoyez le modèle d'entraînement uniquement avec de l'eau et une solution savonneuse légère, si nécessaire, lavez-le sous l'eau courante. Ne submergez pas le modèle et n'utilisez pas de grandes quantités de liquide pour le laver.
- Ne retirez pas le produit de la base original.




## Stockage et transport


- Conservez toujours le produit dans un endroit frais, à l'abri du soleil.
- Transporter le produit dans son emballage.
- Assurez-vous qu'il n'y a rien à l'intérieur de l'emballage qui pourrait endommager votre produit.



## Structures internes

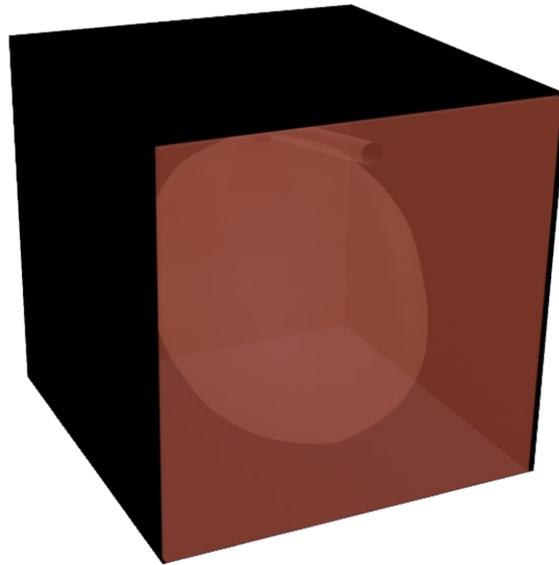

|          |       |
|----------|-------|
| Longueur | 12 cm |
| Hauteur  | 12 cm |
| Largeur  | 12 cm |

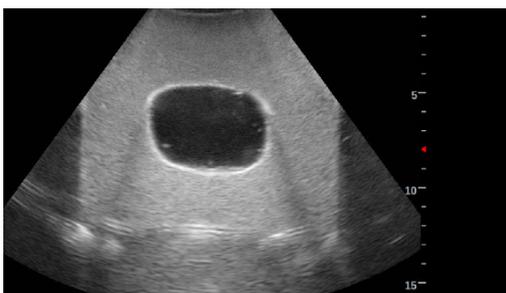

Images échographiques en mode B du modèle.



# ENTRER EN CONTACT



http://

[www.gphantom.com.br](http://www.gphantom.com.br)



[contato@gphantom.com.br](mailto:contato@gphantom.com.br)



(16)99848-2468



Gphantom



@gphantomtm



Gphantom

Consultez la faisabilité du développement sur mesure  
d'un produit Gphantom pour vos besoins.

Les Gphantoms bénéficient d'une garantie de 3 mois contre les défauts de fabrication à compter de l'émission de la facture.